

PREGÃO PRESENCIAL N.º 070/2017
ATA N.º 001/2017

Às quatorze horas do dia dezessete de agosto de 2017 na sala de licitações da Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca, o PREGOEIRO e a EQUIPE DE APOIO, designados pela Norma n.º 17/2017, de 14 de abril de 2017 reuniram-se com o objetivo de abrir e processar a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, de que trata o **Processo Licitatório n.º 131/2017**, destinado à aquisições de **Equipamentos Médico Hospitalares**, conforme especificações detalhadas no Edital e em seus anexos.

As empresas que se cadastraram para a presente licitação são:

- **INTER CTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP – CNPJ n.71.631.238/0001-63**, devidamente representada pelo **Fábio Augusto Dantas**, portador da cédula de identidade RG n.º 43.900.332-5 SSP/SP.
- **LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA – CNPJ n.04.187.384/0001-54**, devidamente representada pelo **Roberto Daniel França da Silva**, portador da cédula de identidade RG n.º 34.59.832-6 SSP/SP

ANÁLISE DA DESCRIÇÃO TÉCNICA DETALHADA

ITEM 1 – VENTILADOR PULMONAR PRESSOMÉTRICO E VOLUMÉTRICO.

- Para este item foram apresentadas propostas pelas empresas Inter CTI e Leistung.

Questionamentos INTER CTI para LEISTUNG: Modalidade de ventilação para neonatal e volume garantido. Ajustes de fluxo inspiratório ate 120 lpm. Sensor paramagnético. Não possui entrada para bateria externa. Armazenagem de ocorrência de histórico de 72 horas. Ventilação de backup, todas as modalidades. Pausa inspiratória manual e pausa expiratória manual.

Resposta: O fornecedor apontou quanto a armazenagem que realmente não faz 72 horas, faz só 24 horas para alarmes e mil eventos. Referente ao ajuste de fluxo inspiratório é automático, e não manual. Não tem entrada para bateria externa. Sensor paramagnético, não tem, é por célula galvânica. Pausa inspiratória manual e expiratória manual não tem. Quanto ao volume garantido, possui somente o controlado, e não o garantido. Portanto, a empresa está desclassificada.

Questionamento equipe técnica para LEISTUNG: Alarme de alto peep.

Resposta: O fornecedor constatou que não tem o alarme de alto peep.

Questionamento equipe técnica para INTER CTI: Parâmetros monitorados em BTPS

Resposta: O fornecedor apontou na página 144 do manual os parâmetros exigidos.

ETAPA DE PROPOSTAS E LANCES:

ITEM 1 – VENTILADOR PULMONAR PRESSOMÉTRICO E VOLUMÉTRICO.

QUANTIDADE – 02 UNIDADES

EMPRESAS	INTER CTI
VALOR TOTAL PROPOSTA	R\$99.900,00
VALOR UNITÁRIO	R\$49.950,00
	R\$49.400,00
VALOR UNITÁRIO	R\$49.400,00
VALOR TOTAL	R\$98.800,00

- Segue na tabela abaixo o menor valor registrado por item:

Item / Empresa	INTER CTI
1.	R\$98.800,00

ANALISE DE DOCUMENTAÇÃO:

A empresa credenciada e vencedora na etapa de descrição técnica apresentou todas as documentações. Por isso esta habilitada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Fica registrado que as empresas participantes do pregão se fizeram presente e que não manifestaram interesse em recorrer a cerca de qualquer aspecto e/ou fases do procedimento.


Nada mais a constar, assinam a presente ata o pregoeiro, os integrantes da equipe de apoio e os representantes das empresas credenciadas no processo.

Franca, 17 de agosto de 2017.

GILSON CLEBER DOS SANTOS
PREGOEIRO

BRUNA DE MELO ULHOA
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO

LILIAN CAMPOS GALVÃO FACCIROLI
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO

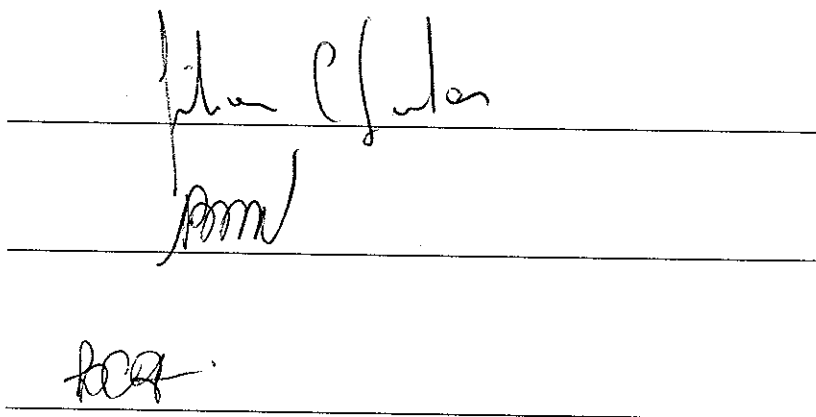

RENATO SEICHI OKAMOTO
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO

Renato Okamoto

FABIO AUGUSTO DANTAS
INTER CTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
EPP

Fabio Dantas

ROBERTO DANIEL DA FRANÇA SILVA
LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA

Roberto Daniel

Amw
1000
1/1