

**PREGÃO PRESENCIAL N.º 075/2018**  
**ATA N.º 001/2018**

Às **quatorze horas do dia sete de maio de 2018** na sala de licitações da Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca, o PREGOEIRO e a EQUIPE DE APOIO, designados pela Norma n.º **17/2017**, de 14 de junho de 2017 reuniram-se com o objetivo de abrir e processar a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, de que trata o **Processo Licitatório n.º 136/2018**, destinado à aquisições de **Equipamentos Médico Hospitalares**, conforme especificações detalhadas no Edital e em seus anexos.

As empresas que se cadastraram para a presente licitação são:

- **VIVAMED EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA-EPP – CNPJ n.06.131.330/0001-00**, devidamente representada pelo **Ayslan Rigieri Simões Peixeiro**, portador da cédula de identidade RG n.º 44.325.493-x SSP/SP.
- **INTER CTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP – CNPJ n.71.631.238/0001-63**, devidamente representada pelo **Fábio Augusto Dantas**, portador da cédula de identidade RG n.439003325 SSP/SP

**ANÁLISE DA DESCRIÇÃO TÉCNICA DETALHADA**

ITEM 1 – VENTILADOR PULMONAR PRESSOMÉTRICO E VOLUMÉTRICO.

- Para este item foi apresentada propostas pelas empresas Vivamed e Inter CTI.

**Questionamentos empresa INTERCTI para VIVAMED:**

- 1 – É solicitado o recurso de nebulização incorporada ao equipamento sem alteração do FiO2 ajustada.
- 2 – Armazenamento do histórico de todas as ocorrências de alarmes e eventos ocorridos nas últimas 72 horas ou no mínimo dos últimos 5.000 registros.
- 3 – Sensor paramagnético ou ultrassônico.

**Resposta empresa VIVAMED:**

- 1 – O recurso de nebulização incorporada ao equipamento sem alteração do FiO2 se encontra na página 39 do manual, porém não afirma que é sem alteração e sim que compensa o FiO2.
- 2 – O armazenamento de alarmes e tendências se encontra na página 48 do manual.
- 3 – O sensor se encontra na página 07 item 2.3 como opcional paramagnética no manual e na proposta, porém no edital é solicitado como obrigatório.

Portando a empresa está desclassificada. A empresa manifestou interesse em entrar com recurso.

**Questionamentos da Fundação para VIVAMED:**

- 1 – Ter ventilação não invasiva opcional.

**Resposta empresa VIVAMED:**

- 1 – Na proposta fala como opção, porém no manual da ANVISA tem.

**ETAPA DE PROPOSTAS E LANCES:**

**ITEM 1 – VENTILADOR PULMONAR PRESSOMÉTRICO E VOLUMÉTRICO.**

QUANTIDADE – 05 UNIDADES

PROPOSTA	R\$ 249.800,00
<b>LANCES UNIT.</b>	<b>R\$ 49.960,00</b>
1	R\$ 49.960,00
Valor unitário	R\$ 49.960,00
Valor Total	R\$249.800,00

- Segue na tabela abaixo o menor valor registrado por item:

Item / Empresa	Inter CTI		
1.	R\$ 249.800,00		

**ANALISE DE DOCUMENTAÇÃO:**

A empresa credenciada e vencedora na etapa de descrição técnica apresentou todas as documentações. Por isso esta habilitada.

**CONSIDERAÇÕES FINAIS**


Fica registrado que as empresas participantes do pregão se fizeram presente e que manifestaram interesse em recorrer a cerca de qualquer aspecto e/ou fases do procedimento.

Nada mais a constar, assinam a presente ata o pregoeiro, os integrantes da equipe de apoio e os representantes das empresas credenciadas no processo.

Franca, 07 de maio de 2018.

**GILSON CLEBER DOS SANTOS**  
**PREGOEIRO**

**BRUNA DE MELO ULHOA**  
**MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO**

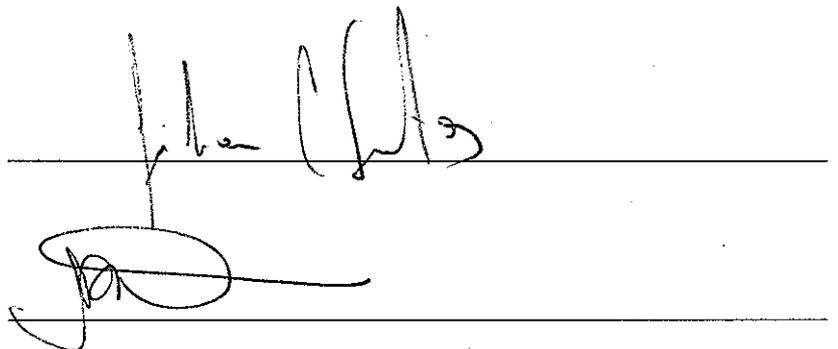



**SANTA CASA  
DE FRANCA**

**LILIAN CAMPOS FACCIROLI  
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO**

*Lilian Campos Facciroli*

**RENATO SEICHI OKAMOTO  
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO**

*Renato Seichi Okamoto*

**AYSLAN RIGIERI SIMÕES PEIXEIRO  
VIVAMED EQUIPAMENTOS MÉDICO-  
HOSPITALARES LTDA-EPP**

*Ayслан Rigieri Simões Peixeiro*

**FÁBIO AUGUSTO DANTAS  
INTER CTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA  
- EPP**

*Fábio Augusto Dantas*

*✓*