

PREGÃO PRESENCIAL N.º 060/2017
ATA N.º 001/2016

Às quatorze horas do dia vinte e dois de junho de 2017 na sala de licitações da Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca, o PREGOEIRO e a EQUIPE DE APOIO, designados pela Norma n.º 16/2017, de 04 de abril de 2017 reuniram-se com o objetivo de abrir e processar a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, de que trata o **Processo Licitatório n.º 121/2016**, destinado à aquisições de **Equipamentos Médico Hospitalares**, conforme especificações detalhadas no Edital e em seus anexos.

As empresas que se cadastraram para a presente licitação são:

- **LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA – CNPJ n.04.187.384/0001-54**, devidamente representada pelo **Gustavo Henrique Silva Toro**, portador da cédula de identidade RG n.º 47511355 SSP/SP.
- **INTER CTI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ n. 71.631.238/0001-63**, devidamente representada pelo **Ricardo Barbosa Souza**, portador da cédula de identidade RG n.º 30.220.090-3 SSP/SP

ANÁLISE DA DESCRIÇÃO TÉCNICA DETALHADA

ITEM 1 – VENTILADOR PULMONAR PRESSOMÉTRICO E VOLUMÉTRICO.

- Para este item foi apresentada propostas pela empresas InterCti e Leistung.

Questionamentos empresa InterCTI: Histórico de eventos e alarmes de 72 horas e o da Leistung é por só por eventos (1000 eventos). Suspiro VCV e PCV. Alarme de alto pep. Pausa inspiratória e expiratória manual. Alarme de alto/baixo frequência respiratória. Ventilação de backup com atuação em todas as modalidades.

Resposta empresa Leistung: A análise técnica disse que quanto ao ventilador inoperante o microprocessador atende e quanto a ventilação de backup foi conferido o manual e constatou-se que não possuem todas mesmo. A empresa Leistung se manifestou a respeito do Suspiro VCV consta na pagina 23 do manual, após conferencia da área técnica da fundação constatou-se que possui. Alarme de AUTOPEEP consta na pagina 25 do manual, após conferencia da área técnica constatou-se que tem o modulo de AUTOPEP porém não se localizou o alarme, por isso o fornecedor não possui esse parâmetro. Pausa inspiratória e expiratória manual, a empresa alega que o deles é automática, a análise da área técnica alega que a automática e manual são distintas, com isso eles não possuem esse parâmetro. Alarme de alto/baixo a empresa alega ter, pois o alarme de baixa seria quando o paciente esta em apneia, porém, após discussão técnica entre os participantes constatou-se a diferença de alarme de apneia e frequência mínima (baixa), portanto a empresa Leistung não possui esse parâmetro. O Suspiro PCV não possui. Por isso a empresa Leistung esta desclassificada. O fornecedor manifestou interesse em ata de entrar com recurso.



ETAPA DE PROPOSTAS E LANCES:

ITEM 1 – VENTILADOR PULMONAR PRESSOMÉTRICO E VOLUMÉTRICO

QUANTIDADE – 02 UNIDADE

InterCTI	
PROPOSTA	R\$ 99.900,00
LANCES UNIT.	R\$ 49.950,00
1	R\$ 49.400,00

- Segue na tabela abaixo o menor valor registrado por item:

Item / Empresa	InterCTI		
1.	R\$98.800,00		
2.			
3.			

ANALISE DE DOCUMENTAÇÃO:

A empresa credenciada e vencedora na etapa de descrição técnica apresentou todas as documentações. Por isso esta habilitada.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Fica registrado que a empresa participante do pregão se fez presente e que não manifestou interesse em recorrer a cerca de qualquer aspecto e/ou fases do procedimento.

Nada mais a constar, assinam a presente ata o pregoeiro, os integrantes da equipe de apoio e os representantes das empresas credenciadas no processo.

Franca, 22 de junho de 2017.

**GILSON CLEBER DOS SANTOS
PREGOEIRO**

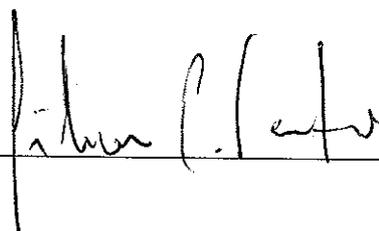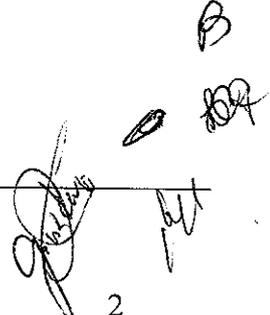

**SANTA CASA
DE FRANCA**

**BRUNA DE MELO ULHOA
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO**

Bruna de Melo Ulhoa

**LILIAN CAMPOS FACCIROLI
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO**

Lilian Campos Faccirolí

**RENATO OKAMOTO
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO**

Renato Okamoto

**GUSTAVO HENRIQUE SILVA TORO
LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA**

Gustavo Henrique Silva Toro

**RICARDO BARBOSA SOUZA
INTER CTI COMERCIO E SERVIÇOS
LTDA**

Ricardo Barbosa de Souza

[Handwritten initials]
3
17